

検査結果書

報告書 No. R11-2016-0942
発行年月日 2016年9月21日

長野県大町市大町3500-1

AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場

御中



クマタ分析センター 株式会社
滋賀県草津市笠山七丁目4番52号
〒525-0072 電話 077 (567) 2416
検査責任者 小野 由美子

檢查責任者

小 野 由 美

検査の結果を以下のとおり報告いたします。

検 体 受 理 日	2016年9月5日	商 品 名	ワンウェイ天然水
製 造 者	AW・ウォーター株式会社	賞 味 期 限	2017年6月1日
製 造 場 所	信濃大町工場	製 造 日	2016年9月2日
検査開始月日	2016年9月5日	販 売 者	---
	検査終了月日		2016年9月14日

項目		結果	基準値	項目		結果	基準値
1	放射性ヨウ素 (I-131)	検出限界未満	— Bq/kg				
2	放射性セシウム (Cs-134)	検出限界未満	— Bq/kg				
3	放射性セシウム (Cs-137)	検出限界未満	— Bq/kg				
		-以下余白-					

判 定

基準をはずれた項目 ---

コード	クリタ分析センター株式会社 70209/BF164077	依頼者	M00095 若尾 空
送付先	営業部営業二課名古屋営業所		

備考 1. 結果の単位については、それぞれ項目毎に基準の単位と同一。
2. 1から3の項目は、株式会社再春館「安心・安全」研究所にて実施。

水質検査者		
		

試験結果書

第 H1600214-01 号
平成28年9月14日

AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場 様

熊本市中央区帯山4丁目17番1号
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 和久田 俊裕

平成28年9月6日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試 料 名	ワンウェイ天然水
製造(採取)年月日	2016年9月2日

【試験結果】

核 種	I-131	Cs-134	Cs-137
放射性物質濃度	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg	検出限界未満 Bq/kg
検出限界濃度	0.43 Bq/kg	0.48 Bq/kg	0.46 Bq/kg

試 料	試料名	ワンウェイ天然水			
	試料 No.	-	採 取 量	- kg	備考
	採取日	2016年9月2日	供 試 量	2.00002 kg	
	採取時刻	-	前処理法	なし	

試 験 方 法	γ 線スペクトル測定				
検出器	ゲルマニウム半導体検出器 GC-2520 7500SL (CANBERRA)				
測定日時	2016/9/7 19:54				
測定時間	3000				sec
使用容器	マリネリ容器(2L)	形 状		液体	
試料高さ	- mm	備 考		-	
核種	I-131	Cs-134		Cs-137	
検出ピークチャンネル	728.61 ch	1209.07 ch	1323.04 ch		
検出ピーク領域	725~732 ch	1205~1213 ch	1319~1327 ch		
検出ピークエネルギー	364.48 keV	604.66 keV	661.64 keV		
グロスカウント	20.0 counts	6.0 counts	5.0 counts		
バックグラウンド	21.6 ± 4.2 counts	13.5 ± 3.5 counts	7.2 ± 2.5 counts		
妨害カウント	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts		
ピークバックグラウンド	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts	0.0 ± 0.0 counts		
ピーク面積	-1.6 ± 6.1 counts	-7.5 ± 4.3 counts	-2.2 ± 3.4 counts		
放出比	81.00 %	97.56 %	85.00 %		
半減期	8.04 D	2.06 Y	30.20 Y		
減衰補正係数	1.00	1.00	1.00		
検出限界	23.7 counts	20.3 counts	16.5 counts		
計算方法	積算法	積算法	積算法		
備考	減衰補正なし				



株式会社 再春館安心安全研究所

〒 862-0924 熊本市中央区帯山4丁目17番1号

TEL:(096)385-1222 FAX:(096)385-1221 kensa@anshin-saishunkan.co.jp

スペクトルグラフ

測定コード M120160907195354

検出器番号 1

測定日時 2016年09月07日 19時54分


ライブタイム

3000 秒

リアルタイム

3001 秒

ランウェイ天然水

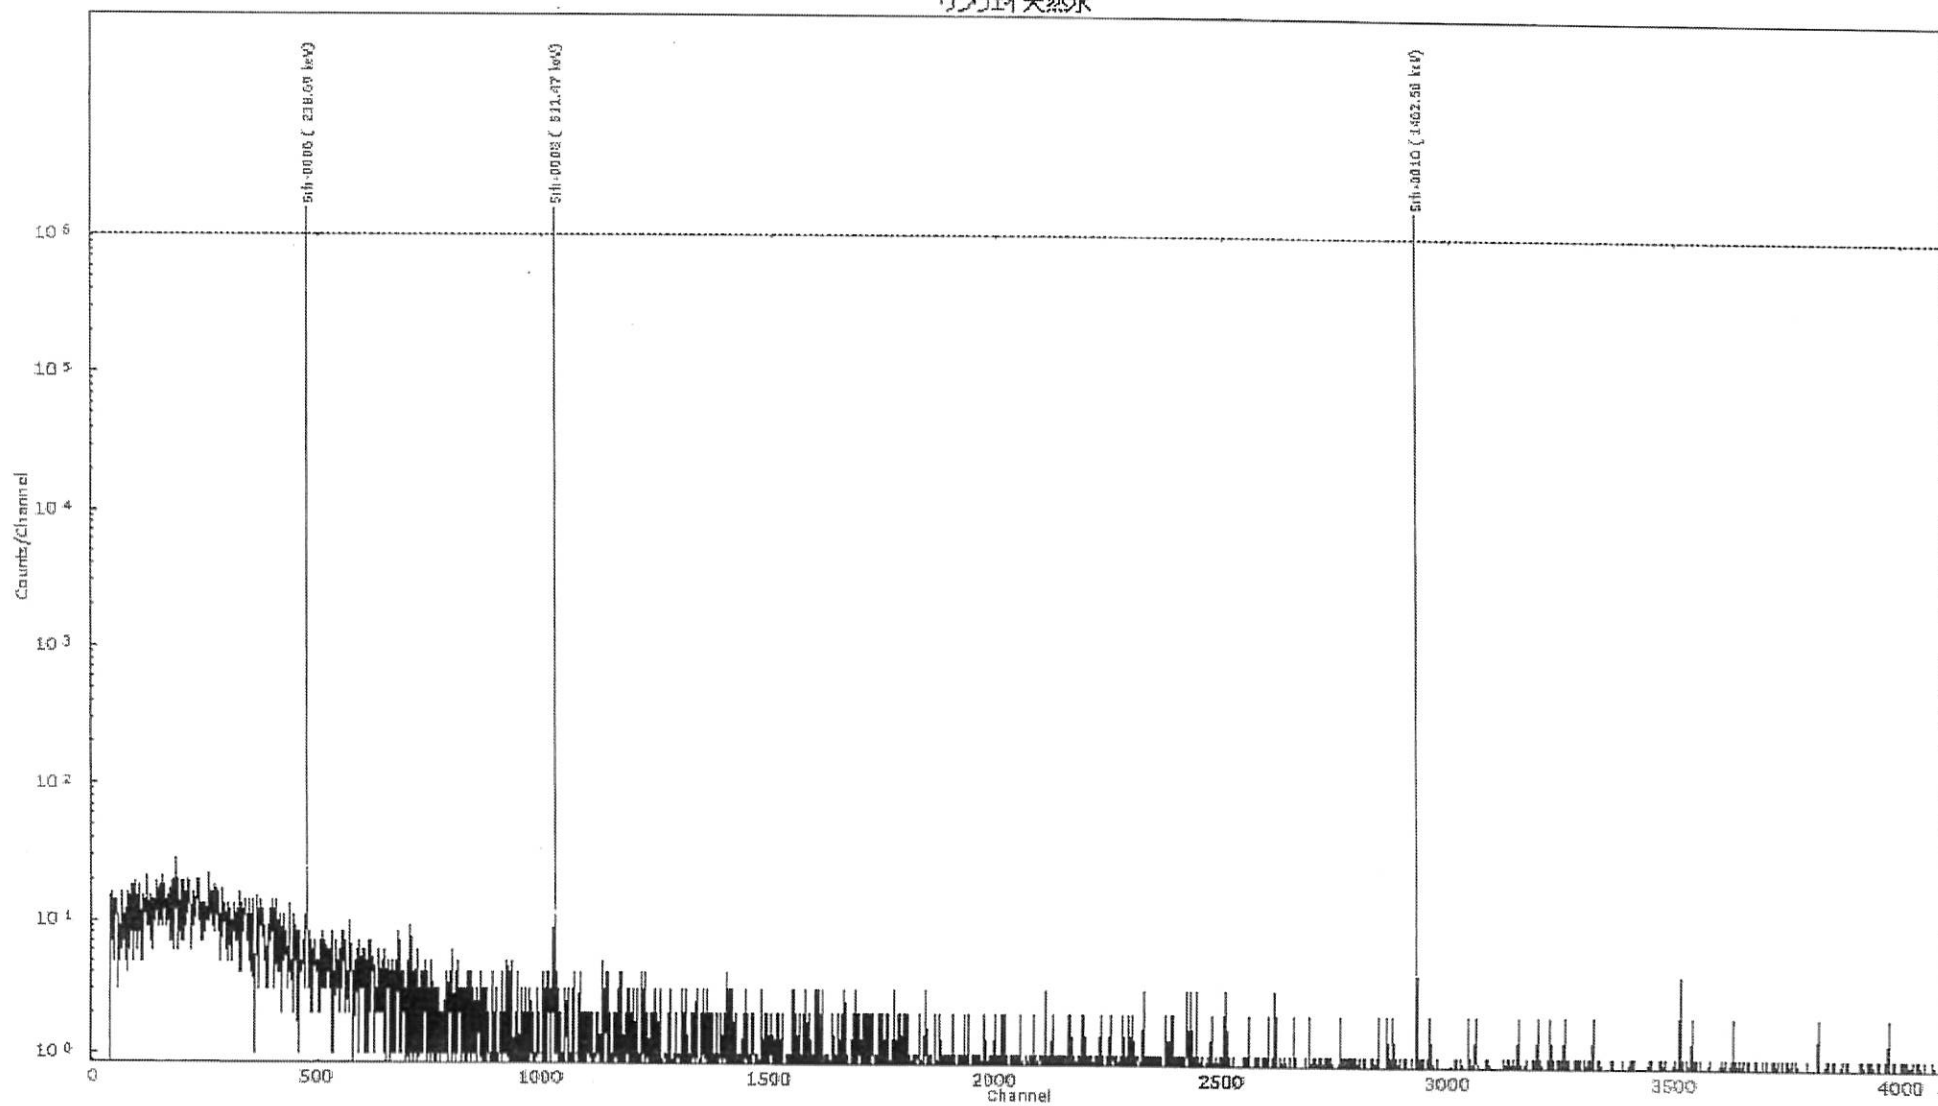

スペクトルグラフ

測定コード B120160826192738

検出器番号 1

測定日時

2016年08月26日 19時28分

ライブタイム

172800 秒

リアルタイム

172828 秒

